

LES BEAUX JOURS APPROCHENT,
PROPOSEZ À VOS PATIENTES DES
PRODUITS DE COMPRESSION MÉDICALE
DE SAISON ADAPTÉS À LEURS ATTENTES

LE SAVIEZ VOUS ?

PRÈS D'1 FEMME SUR 2
ABANDONNE SON TRAITEMENT DE
COMPRESSION À L'APPROCHE DES
BEAUX JOURS⁽¹⁾

POURQUOI ?

Aucun produit de compression ne correspond à leurs attentes (produit confortable, qui ne tient pas chaud, esthétique, transparent, adapté à leurs habitudes vestimentaires).



LES LABORATOIRES INNOTHERA ONT LA SOLUTION !
DÉCOUVREZ / REDÉCOUVREZ LA TRANSPARENCE SOUS
TOUTES LES FORMES À LA FRANÇAISE



Varisma®
Nuances



SMARTLEG®
Transparent




SMARTLEG® BB
Transparent

Votre patiente porte
DES MI-BAS OU BAS AUTOFIX ?
Proposez-lui


Votre patiente porte
SOUVENT DES COLLANTS ?
Proposez-lui

Votre patiente est
ENCEINTE ?
Proposez-lui Smartleg® BB Transparent

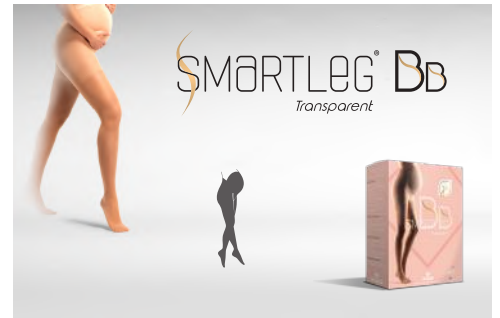

LA TRANSPARENCE SOUS TOUTES LES FORMES À LA FRANÇAISE

CLASSE II

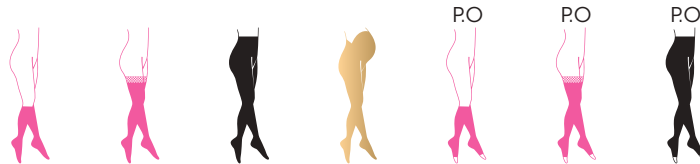


Varisma®
Nuances



SMARTLEG®
Transparent



SMARTLEG® BB
Transparent

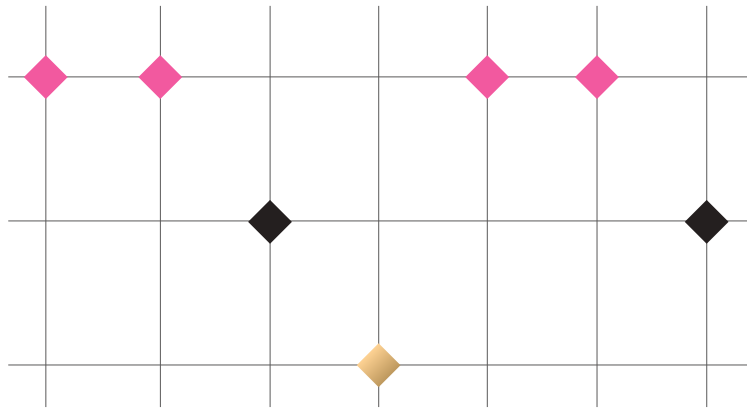

7 TEINTES "EFFET PEAU NUE" ET 1 COLORIS NOIR



(2)(3)
98%
TAUX DE COUVERTURE

(4)(5)
F.I.P.
FOOT IMPROVED PROFILE

(8)(9)
SOLIDITÉ



www.varisma-innothera.com / www.smartleg.fr
LA SCIENCE AU SERVICE DE LA COMPRESSION VEINEUSE



1 - "La contention d'été idéale" - 1999 (étude ID Recherche Marketing)

2 - Etude interne - ET_2017_043 TCV SmartLeg

3 - ET_2018_094 (TCV = 98,0%) - Taux de couverture Varisma® Nuances Bas.

4 - Profil de pressions spécifiquement adapté à la zone pied - Brevet FR 2885035 : "orthèse compressive du membre inférieur en forme d'article tricoté de type bas, chaussette ou collant".

5 - Thiney G, Becker F, Ouchène A. Observance et compression veineuse élastique. Etude de la facilité d'enfilage et des sensations au porter précoces. Phlébologie 2007 ; 60(3) : 293-302.

6 - Brevet FR 2942130 : « Procédé d'évaluation de la tenue sur le membre inférieur d'une orthèse de contention veineuse élastique tricotée ».

7 - Etude de la tenue de la chaussette de compression veineuse élastique / étude en cross-over, en double insu versus produits de référence - n°2009 - A00412 - 55 - novembre 2009.

8 - AP_2019_122 - Synthèse Résistance à la perforation NUANCES.

9 - AP_2019_122 - Résistance à l'usure de Varisma NUANCES vs Concurrents.

Smartleg®Transparent, Smartleg®BB Transparent et Varisma® Nuances sont des produits de compression veineuse élastique des membres inférieurs indiqués dans les affections veineuses chroniques et aiguës. Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec un index de pression systolique < 0,6, *phlegmatia coerulea dolens*, thrombose septique, intolérance/réaction allergique au produit. **Marquage CE.** Dispositif médical de classe I. Remb. Séc. Soc. Inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lire attentivement les instructions figurant sur les étuis spécifiques. Fabricant : Laboratoires Innothéra - Mars 2022 - INN2203199.

LABORATOIRES INNOTHERA S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro B 388 422 594, dont le siège social est situé 22, avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France.