


LA COMPRESSION SANS COMPLEXE

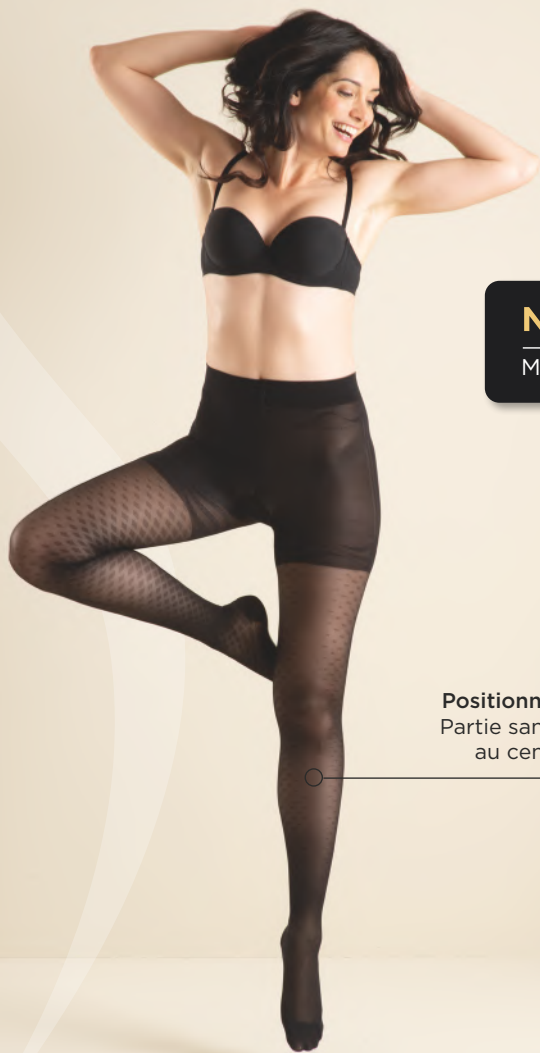

NOUVEAUTÉ
MOTIF « ILLUSION »

Positionnement produit :
Partie sans motif à placer
au centre de la jambe.

La science au service de la compression veineuse
Dispositif médical de compression veineuse élastique
www.smartleg.fr

innothera
LABORATOIRES

SMARTLEG[®]
Collection

MADE IN
FRANCE
CALCULON
RUCV 419200

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.



AVEC DE NOUVELLES FINITIONS POUR ENCORE PLUS D'ESTHÉTISME

TAILLES STANDARD

COLLANT	Illusion
Taille 0 / Court	3664540054809
Taille 0 / Normal	3664540054885
Taille 0 / Long	3664540054724
Taille 1 / Court	3664540054793
Taille 1 / Normal	3664540054878
Taille 1 / Long	3664540054717
Taille 2 / Court	3664540054786
Taille 2 / Normal	3664540054861
Taille 2 / Long	3664540054700
Taille 3 / Court	3664540054779
Taille 3 / Normal	3664540054854
Taille 3 / Long	3664540054694
Taille 4 / Court	3664540054762
Taille 4 / Normal	3664540054847
Taille 4 / Long	3664540054687



Une **sous-ceinture** conçue pour apporter **plus de confort à vos patientes.**



Pointe et talon plus discrets pour davantage d'élégance dans les chaussures échancrées.

Pointe et talon plus solides⁽¹⁾⁽²⁾.

TAILLES +

COLLANT	Illusion
Taille 1+ / Court	3664540054755
Taille 1+ / Normal	3664540054830
Taille 1+ / Long	3664540054670
Taille 2+ / Court	3664540054748
Taille 2+ / Normal	3664540054823
Taille 2+ / Long	3664540054663
Taille 3+ / Court	3664540054731
Taille 3+ / Normal	3664540054816
Taille 3+ / Long	3664540054656



Semelle type chevron conçue pour un effet **moins glissant** dans les chaussures.

1 - 2022-005 Résistance en "I" Talon SMARTLEG et SMARTLEG Trans 2.0_29.11.22
2 - 2022-012 Résistance pointe Smartleg Transparent 2.0_17.05.22

La science au service de la compression veineuse

Dispositif médical de compression veineuse élastique

Smartleg® Collection est un produit de compression veineuse élastique des membres inférieurs indiqué dans les affections veineuses chroniques et aiguës. Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec un index de pression systolique < 0,6, *phlegmatia coerulea dolens*, thrombose septique, intolérance/réaction allergique au produit. **Marquage CE.** Dispositif médical de classe I. Remb. Séc. Soc. Inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étui. Fabricant : Laboratoires INNOTHERA - Septembre 2023 - INN2307119.

LABORATOIRES INNOTHERA S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro B 388 422 594, dont le siège social est situé 22, avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France.

www.smartleg.fr

CONTACTEZ NOTRE
CENTRE D'APPELS :

0 800 400 067

Service & appel
gratuits